



www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE PRESION

N° CERTIFICADO : SMT290523_19

TAG : PT_1

DATOS DEL CLIENTE / FECHA

CLIENTE: CENTRAL YUNGAY S.A.

RUT: 76.060.441-0

DIRECCION : Camino al Manzano Km 2.5, Localidad de Charrúa - Comuna de Cabrero

TIPO EMPRESA : GENERACION

FECHA EMISION:
29-06-2023

DESCRIPCION EQUIPO

MARCA : SIEMENS

RANGO : 0 A 100 [mBar]

MODELO : 7MF1566-3AA00-1GA1

SALIDA : 4 A 20 mA

TIPO : TRANSMISOR DE PRESION MANOMETRICO

MONTAJE: 1/2" BSP

N/S : LKK423462010001

FLUIDO : GASES

INSTRUMENTO PATRÓN Y OBSERVACIÓN

PATRON A OCUPAR :

MANOVACUOMETRO

CALIBRADOR DE PROCESO

MARCA :

SIKA

YOKOGAWA

MODELO:

REF-J

CA-71

NUMERO DE SERIE :

922898

T1N5025

CERTIFICADO DE CALIBRACION :

SME-40358

SMF-25597

EMITIDO POR :

CESMEC S.A.

CESMEC S.A.

FECHA CALIBRACION :

24-01-2023

07-02-2023

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_19

TAG : PT_1

DATOS Y ESPECIFICACIONES DE LA CALIBRACION

DESCRIPCION : VERIFICACION DE PRESION EN LA DESCARGA DE LA TURBINA (GASES ESCAPE)

LUGAR CALIBRACION : INSTALACIONES EN ASILEC LTDA.

CONDICIONES AMBIENTALES : TEMPERATURA 18 °C

METODO / PROCEDIMIENTO : COMPARACION DIRECTA CON PATRON TRAZABLE

RANGOS : -1000 A 1000 [mBAR]


GRADUACION : 0,1 [mBAR]

FECHA DE CALIBRACION: 29 DE JUNIO 2023

RESULTADO DE LA VERIFICACION

PUNTOS DE MEDICION	INSTRUMENTOS		ERROR DE INSTRUMENTO	
	INSTRUMENTO PATRON [mBAR]	INSTRUMENTO VERIFICADO [mBAR]	ERROR [mBAR]	ERROR %
1	0,00	0,21	-0,210	-0,210
2	25,00	25,21	-0,210	-0,210
3	50,00	49,98	0,020	0,020
4	75,00	75,11	-0,110	-0,110
5	100,00	100,16	-0,160	-0,160

GRAFICO DE ERROR PORCENTUAL

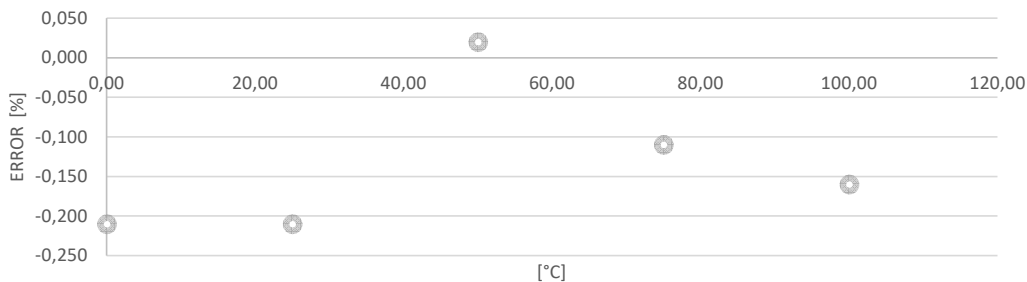



www.asilec.cl
Concepción
fono 41 3163 290
asilec@asilec.cl

CERTIFICADO DE CALIBRACION DE TEMPERATURA

N° CERTIFICADO : SMT290523_19

TAG : PT_1

OBSERVACION

NO SE ENCONTRO NINGUNA ANOMALIA

INFORMACION IMPORTANTE


HUGO MARTINEZ J.
SUPERVISOR TECNICO DE
ASILECLTDA.